Medical–Biological
Research & Technologies

UVR-S

Стойка (подставка)

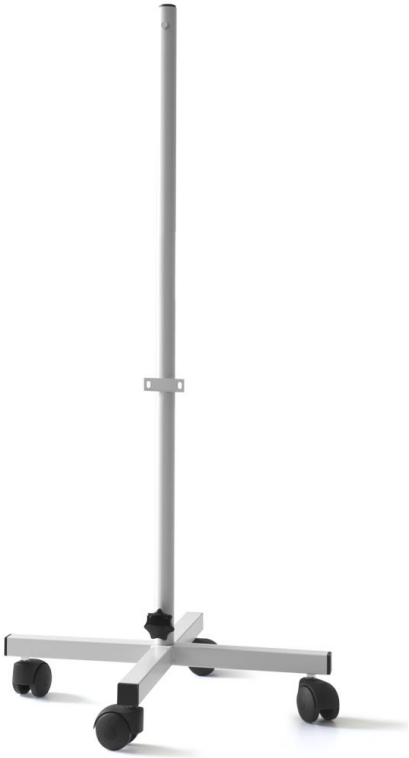

Инструкция пользователя

1. Общая информация

Изделие представляет собой стойку (подставку) для УФ-рециркулятора воздуха, проточного, бактерицидного:

- Модель **UVR-S**

Конструкция стойки позволяет закрепить рециркуляторы моделей **UVR-M** и **UVR-Mi** в вертикальном положении. Производитель SIA Biosan, Латвия.

2. Меры безопасности

- Перед транспортировкой изделия снимите рециркулятор.
- Перемещайте изделие по ровной горизонтальной поверхности.
- Перед эксплуатацией установите изделие в устойчивом положении на ровной горизонтальной поверхности.
- При эксплуатации изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 80%;
  - Превышать допустимую нагрузку на изделие;
  - В процессе сборки и эксплуатации изделия становиться ногами на поверхности изделия и его частей;
  - Использовать для чистки поверхностей вещества, содержащие растворители, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жёсткие губки, щётки.
- Осуществляйте использование изделия по назначению, указанному в маркировке и данной инструкции, а также с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных в главе **Спецификации**.

3. Правила ухода и эксплуатации

3.1. **Распаковка**. Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните оригинальную упаковку для возможной транспортировки или хранения. Внимательно осмотрите изделие на наличие полученных при перевозке повреждений. На такие повреждения гарантия не распространяется. Гарантия не распространяется на изделия, транспортированные не в оригинальной упаковке.

3.2. **Уход за изделием**. По вопросам технической поддержки, свяжитесь с местным дистрибьютором Biosan или с сервисным отделом Biosan.

3.2.1. Очищайте поверхности изделия слегка влажной мягкой салфеткой с добавлением нейтральных (неабразивных) чистящих средств. По окончании уборки удалите всю влагу сухой мягкой тканью. Перед использованием любых способов чистки или дезинфекции, кроме рекомендованных производителем, обсудите с производителем или местным представителем производителя, не вызовет ли этот способ повреждения изделия.

3.2.2. Оберегайте изделие от ударов и падений. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия, избегайте установки на прямых солнечных лучах. Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных материалов, пролитых на изделие или попавших внутрь изделия.

3.3. **Комплектация**. Стойка (подставка), модель **UVR-S**

- Ножка с колёсиками (сталь, пластик) ..... 1 шт.
- Верхний стержень (сталь)..... 1 шт.
- Винт с рукояткой..... 1 шт.
- Инструкция по сборке и эксплуатации..... 1 копия

3.4. **Сборка и установка**. Для сборки понадобится крестовая отвёртка.

- Отключите и обесточьте УФ-рециркулятор, помещаемый на стойку.
- Наденьте верхний стержень (рис. 1/2) на основание в центре ножки (рис. 1/1), вниз стороной с боковым отверстием под винт.
- Скрепите обе части винтом с рукояткой (рис. 1/3).
- Повесьте рециркулятор на стойку (рис. 1/4).
- Снимите рециркулятор со стойки и положите его на горизонтальную поверхность задней стороной вверх. Крестовой отвёрткой выкрутите два винта М3.5, соответствующие месту нижней фиксации на стойке. Повесьте рециркулятор на стойку.
- Крестовой отвёрткой закрепите рециркулятор на стойке двумя винтами М3.5 (рис. 1/5).
- Рециркулятор на стойке готов к подключению к сети и работе.

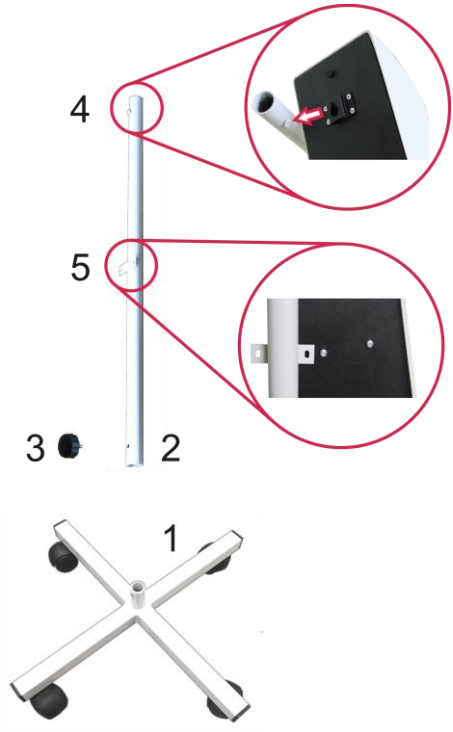

Рисунок 1. Схема сборки

Рисунок 2. Рециркулятор UVR-Mi на стойке

4. Спецификации

Лабораторное изделие изготовлено с применением высококачественных материалов и фурнитуры. Для удобства перемещения устанавливаются пластиковые колеса. Стойка (подставка) разработана и предназначена для фиксации рециркуляторов моделей **UVR-M** и **UVR-Mi** в вертикальном положении.

Изделие разработано для использования в закрытых лабораторных помещениях и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха до 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при 40°C

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию, направленные на улучшение потребительских свойств и качества работы изделия, без дополнительного уведомления.

Модель	**UVR-S**
Диаметр основания	510 мм
Высота (без рециркулятора)	1100 мм
Высота (с рециркулятором)	1150 мм
Максимально допустимая нагрузка	5 кг
Вес, с точностью ±10%	3,1 кг

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия указанной спецификации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год с момента поставки потребителю. Для дополнительной гарантии на изделие, свяжитесь с изготовителем по адресу ниже.

Срок службы изделия – 5 лет с момента поставки потребителю.

Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с нарушением правил эксплуатации.

При обнаружении дефектов потребителем составляется и утверждается рекламационный акт, который высылается по адресу ниже.

Изготовитель:
Biosan SIA
Ул. Ратсупитес 7 к-2, Рига, LV-1067, Латвия
Телефон: +371 67426137
Факс: +371 67428101
http://www.biosan.lv
Сервисный отдел: qc@biosan.lv
Отдел продаж: rustrade@biosan.lv